


平面度測定

検査成績書

測定日: 2019/04/08

測定湿度: 50%

測定温度: 20°C

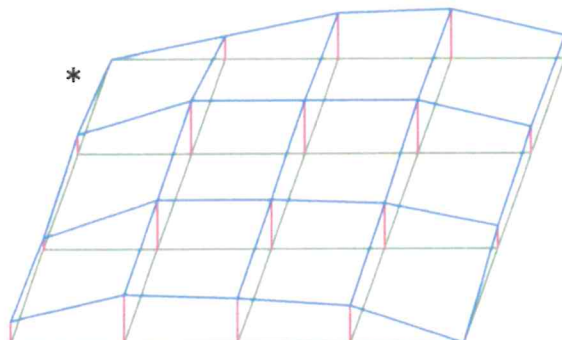

ネームプレート

*	1	2	3	4	5
1	0.0	0.6	1.2	1.3	0.6
2	0.5	1.4	1.4	1.4	0.7
3	0.3	1.3	1.3	1.2	0.6
4	0.6	1.3	1.2	1.0	0.0

This MICRO GRANITE precision-lapped plate has been duly tested and inspected by public authorities using a tractability standard device (Electronic Leveler). Inspected by Wyler Mini Level; Model NT11H-1, Serial No D0331, F0217, G0107, H0242, O2152.

マイクログラナイト・精密石定盤は、公的機関によってトレーサビリティを有する標準器(ワイラ - 電子水準器)を使用して検査,校正されていることを証明します。

*JIS B 7513(対角線と井桁法の混合法)による測定

単位: μm

製品番号: 13620

縦寸法: 300mm

横寸法: 450mm

対角寸法: 540mm

等級: 00級 ($2.0\mu\text{m}$)

測定結果: $1.4\mu\text{m}$

縦ピッチ: 90mm

横ピッチ: 105mm

対角ピッチ: 124mm

判定: 合格

測定機器: MDCシステム

ミニレベル感度: $1\mu\text{m}/\text{m}$

ミニレベルNo.: F0217

有効期限: 2019. 7. 2

測定者: 土井